

リハビックス®-K1号輸液

リハビックス®-K2号輸液

リハビックス® -K1号・K2号輸液 容器・包装変更のご案内

謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につき格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております「リハビックス®-K1号輸液」「リハビックス®-K2号輸液」につきまして、下記の通り、容器及び包装を変更いたしますので、ご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容

容器変更

- 混注用ポートを追加いたします。
- ゴム栓の形状を変更いたします。


●リハビックス®-K1号輸液



●リハビックス®-K2号輸液




ゴム栓の変更

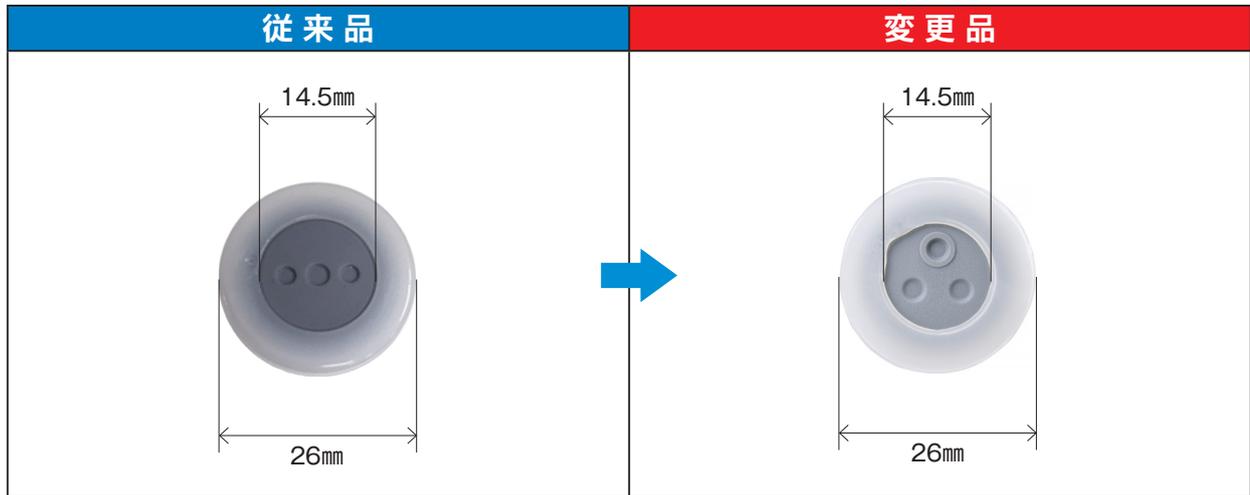


輸送箱デザイン及びサイズの変更

●リハビックス®-K1号輸液

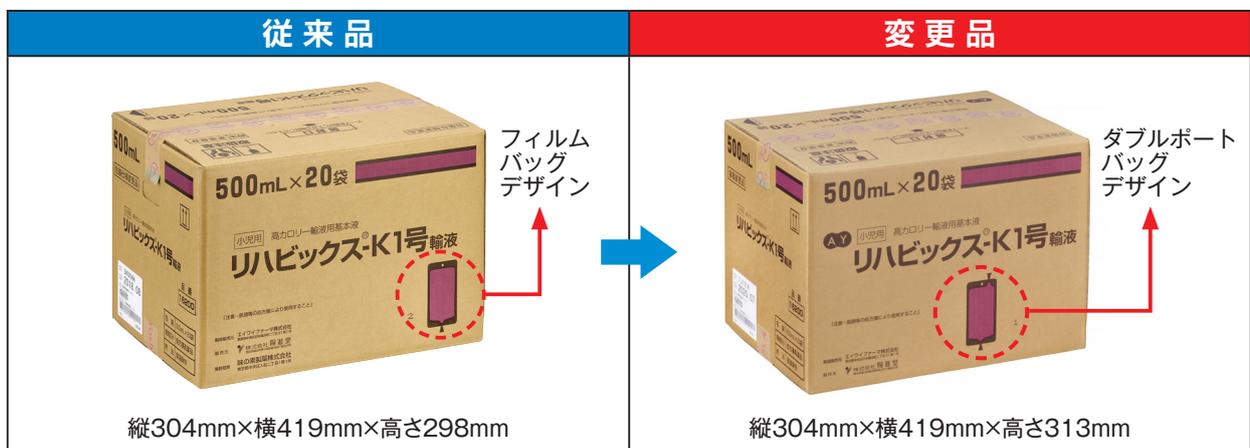

●リハビックス®-K2号輸液 (サイズはリハビックス®-K1号輸液と同じです)

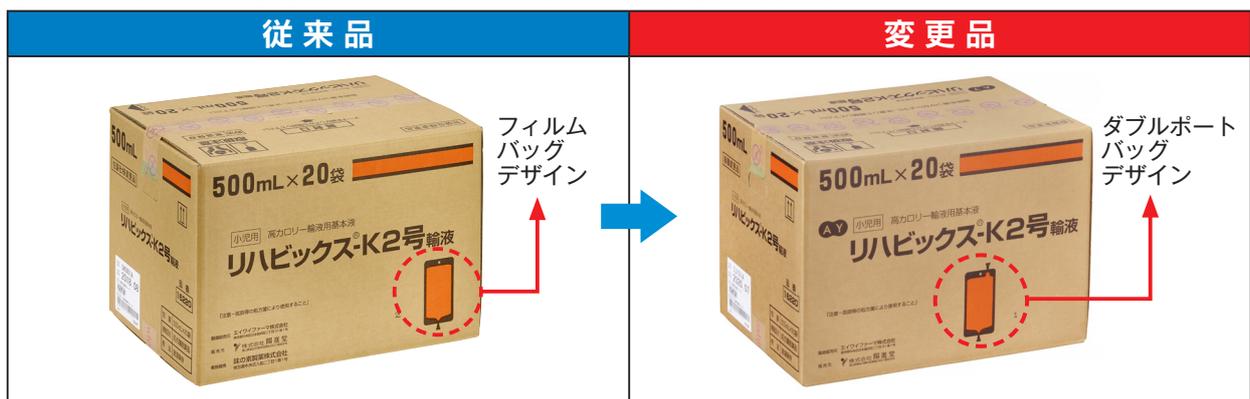

変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

| 販売名 | 包装 | 統一商品コード | 製造番号 | 使用期限 | 出荷予定時期 |
|---------------|-----------|-----------|--------|---------|-----------|
| リハビックス®-K1号輸液 | 500ml×20袋 | 476162004 | 7J101A | 2020年7月 | 2018年2月末 |
| リハビックス®-K2号輸液 | 500ml×20袋 | 476162202 | 7J101A | 2020年7月 | 2018年5月中旬 |

※初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に 容器変更品 の表示をいたします。