

変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期	開封口変更
ソリタ®-T1号輸液	200mL×20本	476162509	4N401	2017年11月	2015年3月下旬	—
	500mL×20本	476162516	4M501	2017年10月	2015年3月中旬	
ソリタ®-T2号輸液	200mL×20本	476162608	未定	未定	未定	—
	500mL×20本	476162615	4M401	2017年10月	2015年2月下旬	
ソリタ®-T3号輸液	200mL×20本	476162707	4N601	2017年11月	2015年4月上旬	—
	500mL×20本	476162714	4M901	2017年10月	2015年3月上旬	
ソリタ®-T3号G輸液	200mL×20本	476162806	4N401	2017年11月	2015年3月上旬	—
	500mL×20本	476162813	4M401	2017年10月	2015年3月上旬	
ソリタ®-T4号輸液	200mL×20本	476162905	未定	未定	2015年7月下旬	—
	500mL×20本	476162912	4M401	2017年10月	2015年3月下旬	
ソリタックス®-H輸液	500mL×20本	476163001	4N401	2017年11月	2015年3月上旬	—
EL-3号輸液	500mL×20袋	476159509	5A701A	2017年12月	2015年3月下旬	—
10%EL-3号輸液	500mL×20袋	476159608	5A601A	2017年12月	2015年4月下旬	—
リナセート®輸液	200mL×20本	476159707	未定	未定	未定	—
	500mL×20袋	476159714	5B401A	2018年1月	2015年5月中旬	
ピカーボン®輸液	500mL×20袋	476159806	5A801A	2017年12月	2015年3月上旬	○
アミニック®輸液	200mL×30袋	476159905	5A501A	2017年12月	2015年3月下旬	○
モリアミン®S注	200mL×30袋	476160000	5C401A	2018年2月	2015年7月中旬	○
モリブロン®F輸液	200mL×30袋	476160109	5A401A	2017年12月	2015年3月下旬	○
ネオアミュー®輸液	200mL×30袋	476160208	5A301A	2017年12月	2015年4月上旬	○

※ 初回出荷より約6ヶ月間、輸送箱に「包装仕様変更品」(ピカーボン®輸液注)、アミニック®輸液、モリアミン®S注、モリブロン®F輸液、ネオアミュー®輸液)および「包装表示変更品」(ソリタ®-T輸液シリーズ、ソリタックス®-H輸液、EL-3号輸液、10%EL-3号輸液、リナセート®輸液)の表示をいたします。

注)ピカーボン®輸液は前回の「包装仕様変更品」の表示と同じになりますので、申し訳ありませんが、天面の開封口変更デザインによりご確認頂くようご了承ください。

輸液製品 包装仕様、包装表示等変更のご案内

謹啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につき格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております弊社輸液関連製品につきまして、『医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項』の一部改正について(平成24年6月29日付医政経発0629第1号、薬食安発0629第1号)に基づきJANコードを削除するのに伴い、包装仕様、包装表示等を変更致しますので、ご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容 ※詳細は裏面をご参照ください。

① JANコード削除

「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について(平成24年6月29日付医政経発0629第1号・薬食安発0629第1号)において、JANコードは平成27年7月以降に製造販売業者から出荷されるものについては表示しないこととされました。本通知に基づき、順次JANコードを削除する予定ですので、あらかじめご案内申し上げます。

※現在のJANコードの位置にGS1コードを移動します。

② 品番コードの追加

従来の個装箱(輸送箱)側面の位置等に製造管理上必要な品番コードを追加します。

(製品には直接関係ありませんのでご了承ください)

③ ケアマークを最新表記に変更

④ 効能効果・用法用量の表示の変更

個装箱の上記表示を「効能・効果、用法・用量、使用上の注意等については添付文書をよくご覧下さい」に変更します。


⑤ 個装箱(輸送箱)の開封口の変更(一部製品)

対象製品：ピカーボン®輸液、アミニック®輸液、モリアミン®S注、モリブロン®F輸液、
ネオアミュー®輸液


以上

個装箱(輸送箱)デザインの変更

例)ピカーボン®輸液

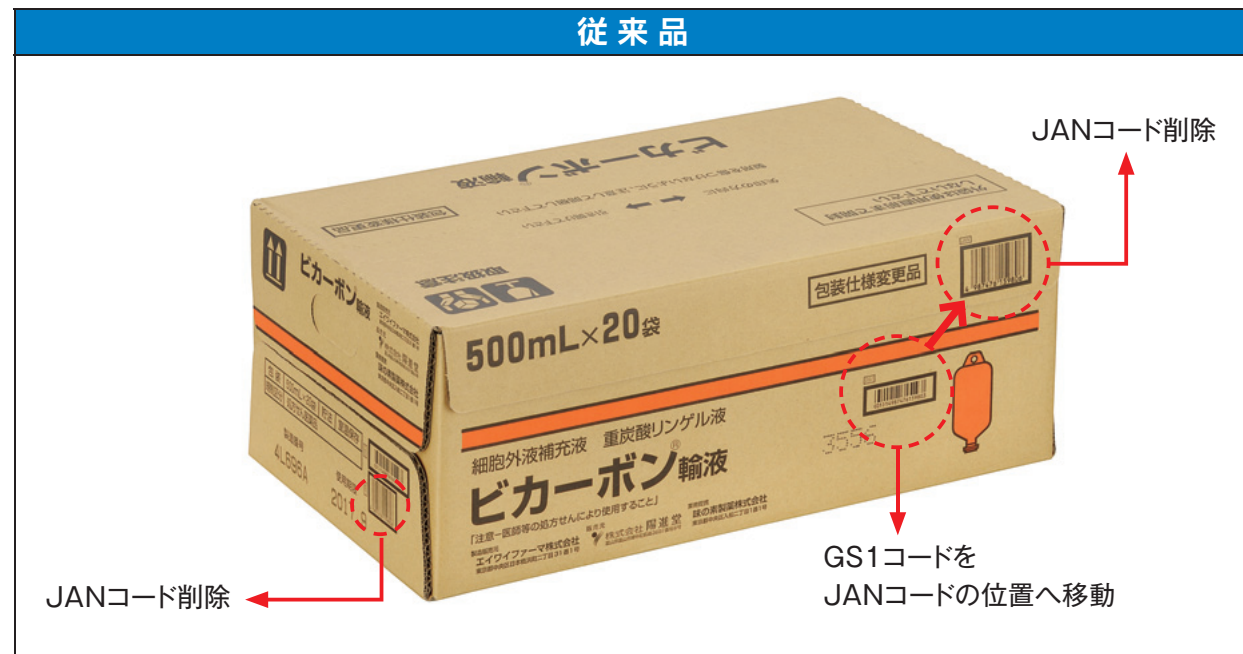

●ケアマークを最新表記に変更

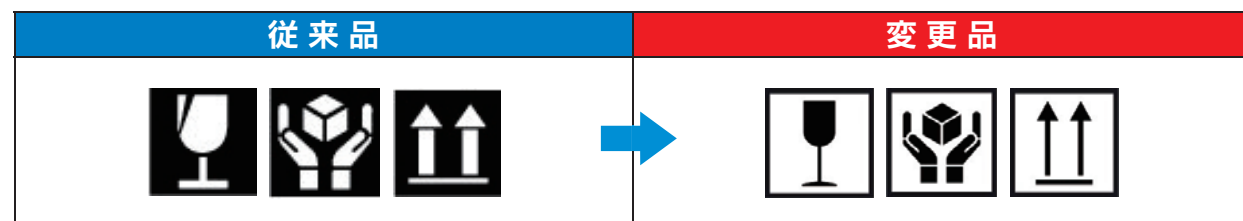

個装箱(輸送箱)の開封口の変更

開封ジッパーを変更し開封方法を変更します。
天面の文字を開封方向に合わせて従来と逆に表示します。

対象製品：ピカーボン®輸液、アミニック®輸液、モリアミン®S注、モリブロン®F輸液、ネオアミュー®輸液
例)ピカーボン®輸液



●開封方法

