

③ B剤包装の印刷色変更



処方箋医薬品^注

人工腎臓透析用粉末製剤

カーボスター[®] 透析剤・P

CARBOSTAR[®] P

注) 注意-医師等の処方箋により使用すること

包装等変更のご案内

謹啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております人工腎臓透析用粉末製剤カーボスター[®]透析剤・Pの包装等を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。


この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

④ B剤包装表面(ラベル)に 添付文書等記載事項はA剤に記載 を追加表記

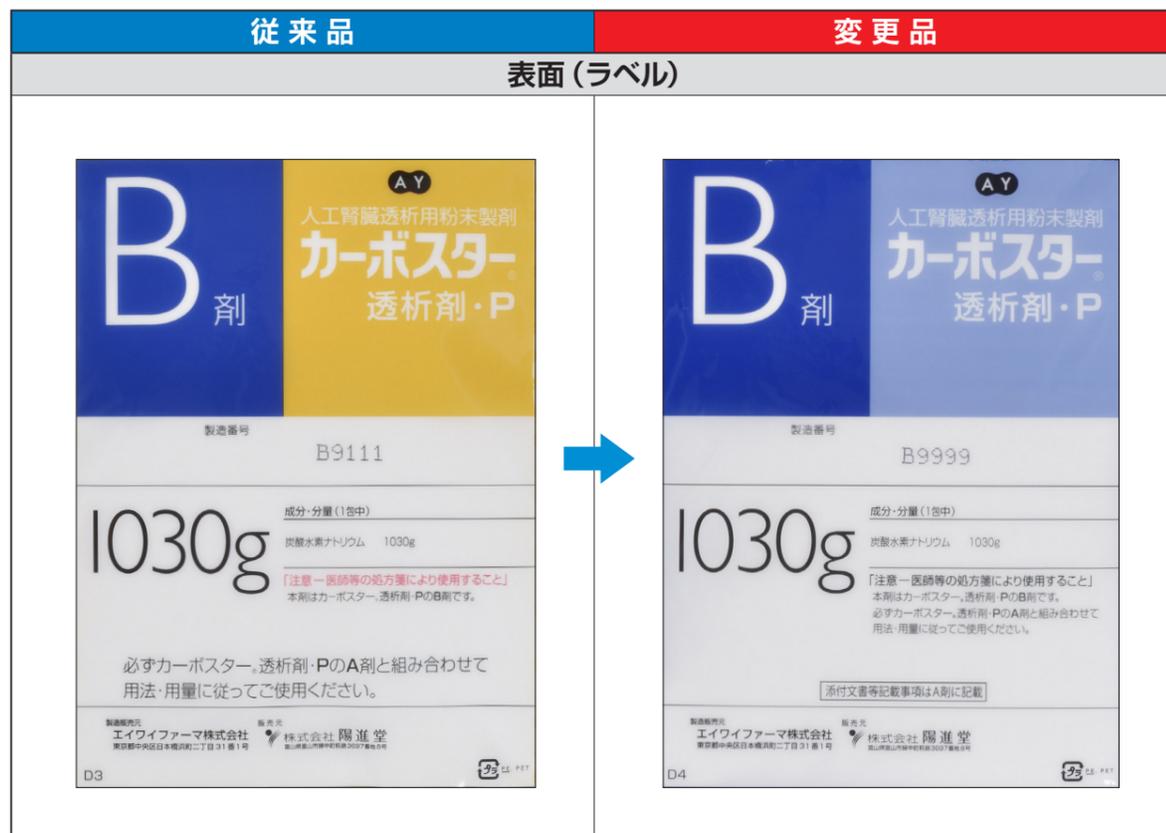

変更内容

1 輸送箱の変更 (次ページ参照)

- ① サイズ変更
- ② 底面テープを無地から陽進堂ロゴ入りテープに変更
- ③ 手掛け穴廃止
- ④ 変更案内表示・使用期限・製造番号をバーコードラベルに表示
- ⑤ 添付文書の封入廃止

2 包装の変更 (3~4ページ参照)

- ① A剤包装表面(ラベル)に希釈調整時の組成(理論値)および用法・用量を記載
- ② A剤包装裏面に添付文書を表示
- ③ B剤包装の印刷色変更
- ④ B剤包装表面(ラベル)に 添付文書等記載事項はA剤に記載 を追加表記

変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通および在庫の関係で時期がずれる場合がございます。何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
カーボスター [®] 透析剤・P	2袋1組×3包	476161601	9K001	2022年8月	2019年11月中旬

※初回出荷より約6ヶ月間、バーコードラベルに [表示・包装変更品] の表示をいたします。

以上

1 輸送箱の変更について

① サイズ変更

従来品	変更品
内寸(幅×奥行×高さ)	内寸(幅×奥行×高さ)
350×208×183	335×198×191

単位: mm

② 底面テープを無地から陽進堂ロゴ入りテープに変更

③ 手掛け穴廃止

④ 変更案内表示・使用期限・製造番号をバーコードラベルに表示


従来品	変更品
短側面	
	
バーコードラベル	
	

⑤ 添付文書の封入廃止

今まで封入して来ましたが、A剤の裏面に表示することになりました。

2 包装の変更について

① A剤包装表面(ラベル)に希釈調整時の組成(理論値)および用法・用量を記載

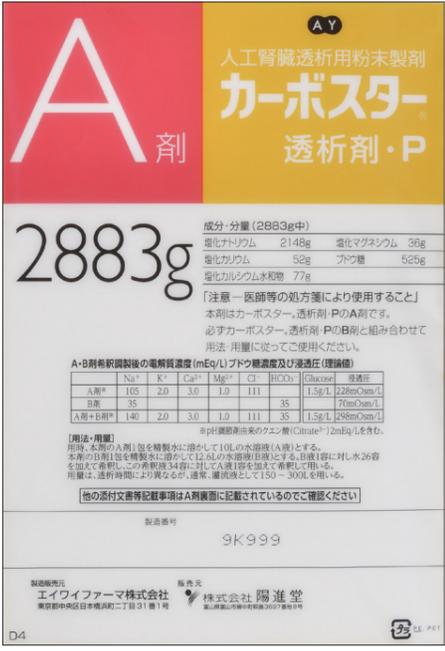従来品	変更品
表面(ラベル)	
	

② A剤包装裏面に添付文書を表示

従来品	変更品
裏面	
	