

# リハビックス®-K1号輸液

# リハビックス®-K2号輸液

## リハビックス® -K1号・K2号輸液 容器・包装変更のご案内

謹 啓

時下、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につき格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております「リハビックス®-K1号輸液」「リハビックス®-K2号輸液」につきまして、下記の通り、容器及び包装を変更致しますので、ご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 白

記

### 変更内容

#### 容器変更

従来のブローバッグ製剤からフィルムバッグ製剤に変更致します。

#### ●リハビックス®-K1号輸液



#### ●リハビックス®-K2号輸液



## 梱包ケースデザイン及びサイズの変更

### ① JANコード削除

『「医療用医薬品へのバーコード表示の実施要項」の一部改正について』（平成24年6月29日付医政経発0629第1号・薬食安発0629第1号）の通知に基づき、JANコードを削除させていただきます。

### ② 販売包装単位コード（GS1コード）への変動情報追加及び元梱包装単位コード（GS1-128）の追加


使用期限・製造番号の変動情報を組み込んだ販売包装単位コード（GS1コード）と商品コード・使用期限・数量・製造番号の情報を組み込んだ元梱包装単位コード（GS1-128）を印字したバーコードシールを梱包ケースの短側面に1枚貼付します。

※なお、バーコードシールへの変更に伴いGS1コード（商品コードのみ）（4側面に印字）を削除します。（反対側の短側面には製造番号・使用期限を直接印字します）


### ③ 品番コードの追加

従来の梱包ケース短側面のGS1固定コードの位置に製造管理上必要な品番コードを追加します。（製品には直接関係ありませんのでご了承ください）


### ④ ケアマークを最新表記に変更

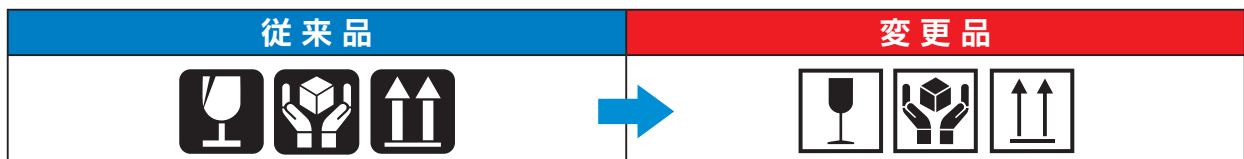

### ● リハビリックス®-K1号輸液

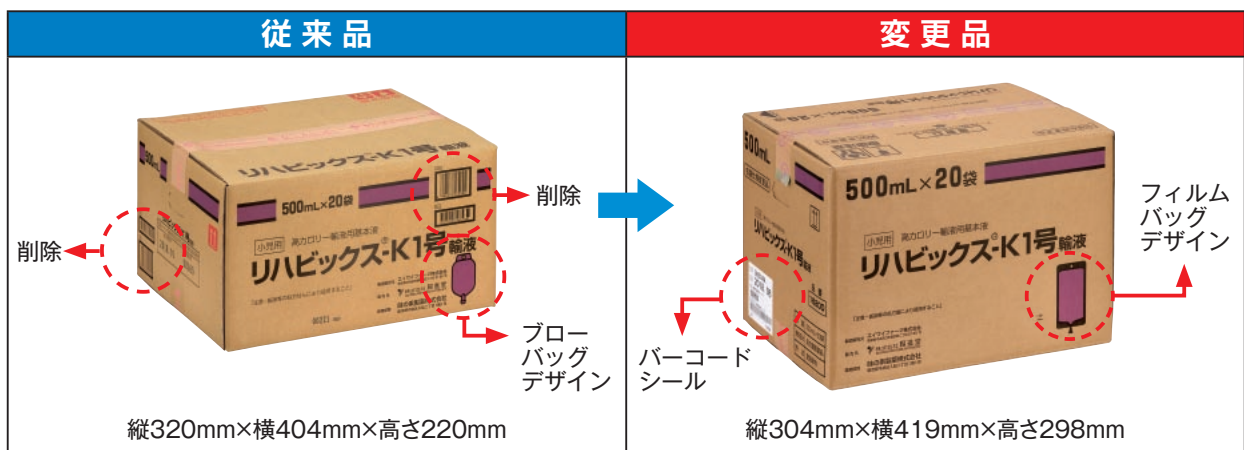

### ● リハビリックス®-K2号輸液（サイズはリハビリックス®-K1号輸液と同じです）

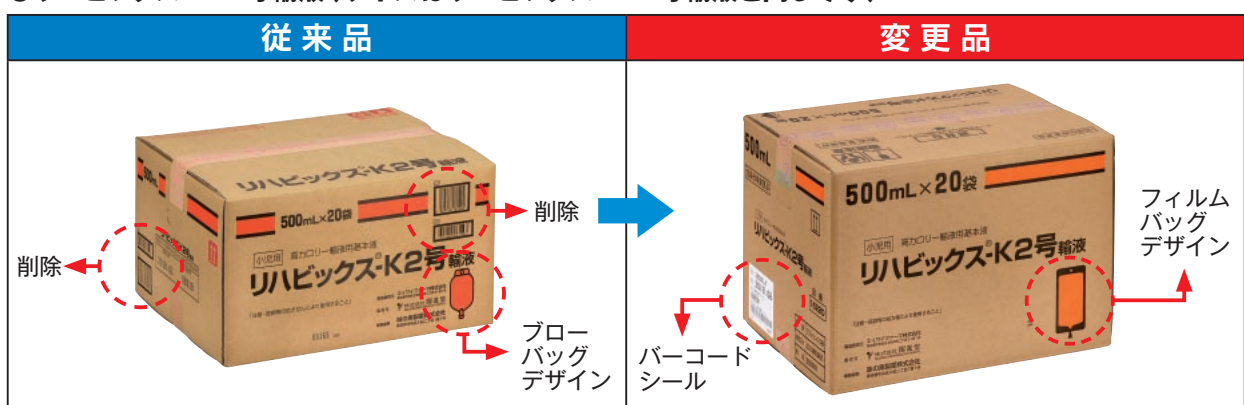

## 変更品の出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
リハビリックス®-K1号輸液	500ml×20袋	476162004	5K004A	2018年8月	2016年1月上旬
リハビリックス®-K2号輸液	500ml×20袋	476162202	5K001A	2018年8月	2016年8月

※初回出荷より約6ヶ月間、梱包ケースに「包装仕様変更品」の表示をいたします。