

人工腎臓用透析液

カーボスター[®]透析剤・L カーボスター[®]透析剤・M

人工腎臓用透析液

AK-ソリタ[®]透析剤・DL AK-ソリタ[®]透析剤・FL AK-ソリタ[®]透析剤・DP AK-ソリタ[®]透析剤・FP

透析ろ過型人工腎臓用透析液

バイフィル[®]透析剤

各種透析剤の包装変更についてのご案内

謹 啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧頂いております各種透析剤の包装を一部変更させていただきま
すので、ここに謹んでご案内申し上げます。

包装の変更に伴い、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、
お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 白


記

変更内容

- カーボスター[®]透析剤・L AK-ソリタ[®]透析剤・DL AK-ソリタ[®]透析剤・FL
 - ・個装箱GS1可変コード対応ラベル貼付
 - ・A剤個装箱ミシン目位置変更 ・ロット付番方法の変更
- バイフィル[®]透析剤
 - ・個装箱GS1可変コード対応ラベル貼付
 - ・個装箱ミシン目位置変更
- カーボスター[®]透析剤・M AK-ソリタ[®]透析剤・DP AK-ソリタ[®]透析剤・FP
 - ・個装箱GS1可変コード対応ラベル貼付


個装箱GS1可変コード対応ラベル貼付及びA剤個装箱ミシン目位置変更

カーボスター®透析剤・L 6L・9L

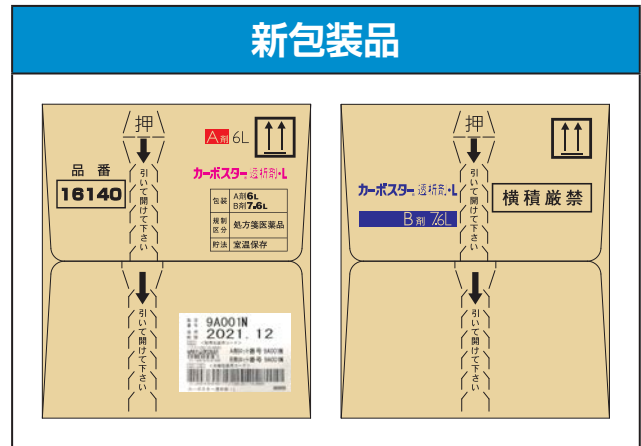


○図はカーボスター®透析剤・L 6Lですが、カーボスター®透析剤・L 9Lも同様の変更です。
○B剤の個装箱に変更はありません。

AK-ソリタ®透析剤・DL AK-ソリタ®透析剤・FL

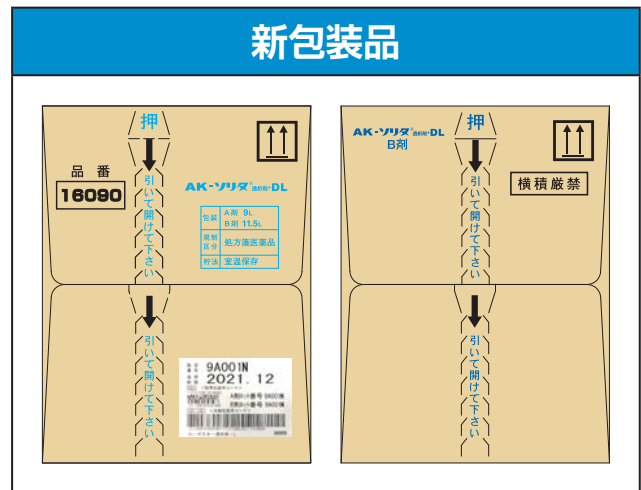

○図はAK-ソリタ®透析剤・DLですが、AK-ソリタ®透析剤・FLも同様の変更です。
○B剤の個装箱に変更はありません。

バイフィル®透析剤

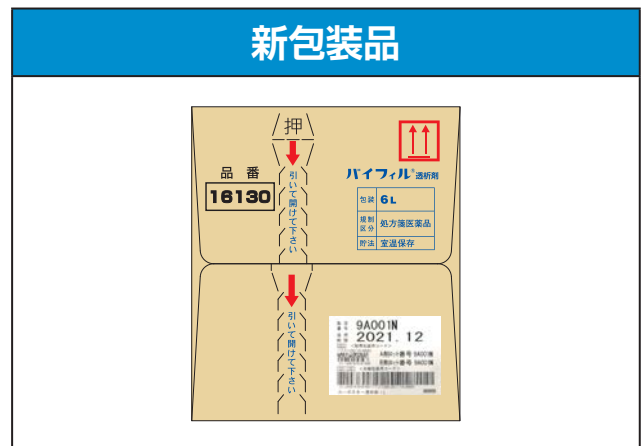

個装箱GS1可変コード対応ラベル貼付

カーボスター[®]透析剤・M



AK-ソリタ[®]透析剤・DP AK-ソリタ[®]透析剤・FP



○図はAK-ソリタ[®]透析剤・DPですが、AK-ソリタ[®]透析剤・FPも同様の変更です。

ロット付番方法の変更

該当製剤 カーボスター[®]透析剤・L AK-ソリタ[®]透析剤・DL AK-ソリタ[®]透析剤・FL

現行の記載方法（記載例）

| A剤ロット | B剤ロット | 製造番号 |
|-------|-------|-------|
| A1001 | B1001 | 1A001 |

新しい記載方法（記載例）

| A剤ロット | B剤ロット | 製造番号 |
|--------|--------|--------|
| 1A001N | 1A001N | 1A001N |
| 1A001N | 1A001W | 1A001W |
| 1A001W | 1A001N | 1A001W |

原則としてA剤、B剤のロット番号を製造番号と同一とし、製造の管理のために、末尾に枝番（NもしくはW）を付与します。

旧包装品の最終製造番号

| 品目 | 包装 | 使用期限 | 製造番号 |
|----------------------------|--------------------|----------|-------|
| カーボスター [®] 透析剤・L | A剤：6L B剤：7.6L | 2023年11月 | ON069 |
| | A剤：9L B剤：11.5L | 2023年10月 | OM908 |
| カーボスター [®] 透析剤・M | A剤：10L B剤：1030g | 2023年11月 | ON740 |
| AK-ソリタ [®] 透析剤・DL | A剤：9L B剤：11.5L | 2023年8月 | OK435 |
| AK-ソリタ [®] 透析剤・FL | A剤：9L B剤：11.5L | 2023年11月 | ON428 |
| AK-ソリタ [®] 透析剤・DP | A剤：9L B剤：672g | 2023年11月 | ON797 |
| AK-ソリタ [®] 透析剤・FP | A剤：9L B剤：738g | 2023年7月 | OJ510 |
| バイフィル [®] 透析剤 | 6L | 2023年9月 | OL422 |

新包装品の出荷案内

新包装品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

| 品 目 | 包 装 | 統一商品コード | 製造 番号 | 使用 期限 | 出荷開始 時期(見込) |
|---------------|--------------------|-----------|----------|--------------|----------------|
| カーボスター®透析剤・L | A剤：6L B剤：7.6L | 476161403 | 1A001N | 2023年 12月 | 2021年 3月下旬 |
| | A剤：9L B剤：11.5L | 476161410 | 1A001N | 2023年 12月 | 2021年 2月下旬 |
| カーボスター®透析剤・M | A剤：10L B剤：1030g | 476161502 | 1B741 | 2024年 1月 | 2021年 3月中旬 |
| AK-ソリタ®透析剤・DL | A剤：9L B剤：11.5L | 476160901 | 1A001N | 2023年 12月 | 2021年 3月上旬 |
| AK-ソリタ®透析剤・FL | A剤：9L B剤：11.5L | 476161106 | 未定 | 未定 | 2021年 7月上旬 |
| AK-ソリタ®透析剤・DP | A剤：9L B剤：672g | 476161007 | 1A798 | 2023年 12月 | 2021年 3月中旬 |
| AK-ソリタ®透析剤・FP | A剤：9L B剤：738g | 476161205 | 未定 | 未定 | 未定 |
| バイフィル®透析剤 | 6L | 476161304 | 未定 | 未定 | 2021年 6月中旬 |

当面の間、カーボスター®透析剤・L、AK-ソリタ®透析剤・DL、AK-ソリタ®透析剤・FL、バイフィル®透析剤は「表示・仕様変更品」、カーボスター®透析剤・M、AK-ソリタ®透析剤・DP、AK-ソリタ®透析剤・FP、は「表示変更品」と表記致します。

以上