

高カロリー輸液用基本液 小児用
処方箋医薬品^{注)}

注) 注意—医師等の処方箋により使用すること

リハビックス®-K1号輸液

リハビックス®-K2号輸液

包装仕様変更のご案内

謹 啓

時下益々ご隆盛のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいております「リハビックス®-K1号輸液」「リハビックス®-K2号輸液」の包装仕様を変更させていただきますので、ここに謹んでご案内申し上げます。

この度の変更につきましては、多大なるお手数をお掛けすることと存じますが、何卒ご容赦の程、お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹 言

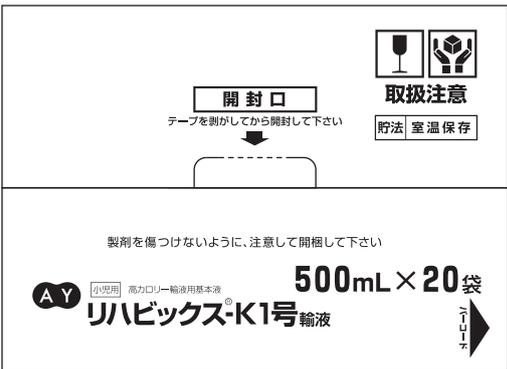
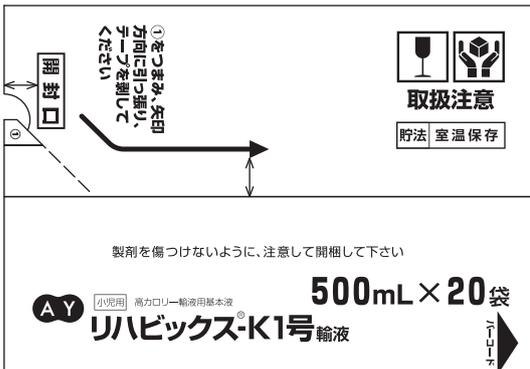
記

変更内容

●個装箱天面の開封仕様変更

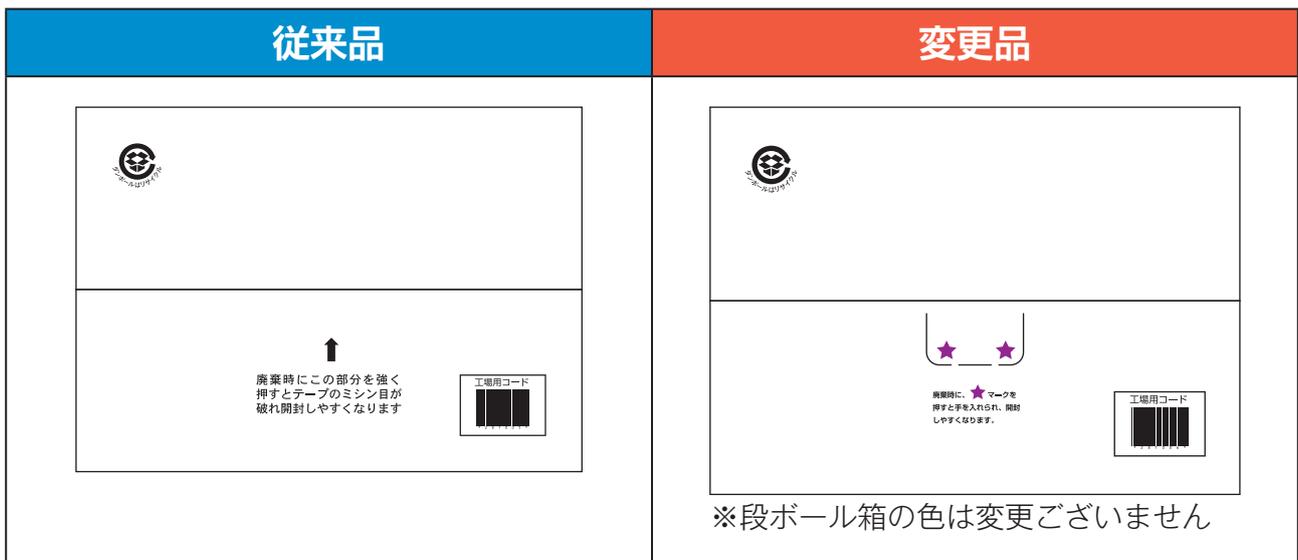
個装箱天面の開封仕様を変更いたします。

例) リハビックス®-K1号輸液

従来品	変更品
	
	※段ボール箱の色は変更ございません

●**個装箱底面の開封仕様変更**

個装箱底面の開封仕様を変更いたします。
リハビックス®-K1号輸液



●**個装箱天面の封緘テープ変更**

個装箱天面の封緘テープをクラフトテープに変更いたします。

●**個装箱底面の封緘テープ変更**

個装箱底面の封緘テープをミシン目なしクラフトテープに変更いたします。

●**個装箱天面のメルト留め廃止**

個装箱天面のメルト留めを廃止いたします。

●**個装箱底面のメルト留め変更**

個装箱底面のメルト留めを8箇所から4箇所に変更いたします。

●**製造記号、使用期限のインクジェット印刷の廃止**

製造番号、使用期限のインクジェット印刷を廃止いたします。

●**混注口のタンパーシール変更**

混注口のタンパーシールを無地に変更いたします。

出荷案内

変更しました製品をお届けする迄には、流通及び在庫の関係で多少時期がずれるかと思われませんが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
リハビックス®-K1号輸液	500mL×20袋	476162004	1F110A	2024年5月	2021年10月中旬
リハビックス®-K2号輸液	500mL×20袋	476162202	1D120A	2024年3月	2021年7月下旬

※初回製造より約6ヶ月間、個装箱に「表示・包装変更品」の表示をいたします。

旧包装品の最終製造番号

販売名	包装	製造番号	使用期限
リハビックス®-K1号輸液	500mL×20袋	1A109A	2023年12月
リハビックス®-K2号輸液	500mL×20袋	1A119A	2023年12月

以上